


Fehlanwendungen

Tragen Sie hier mögliche Fehlanwendungen ein, um diese in der Rezepturverwaltung mit angeben zu können:

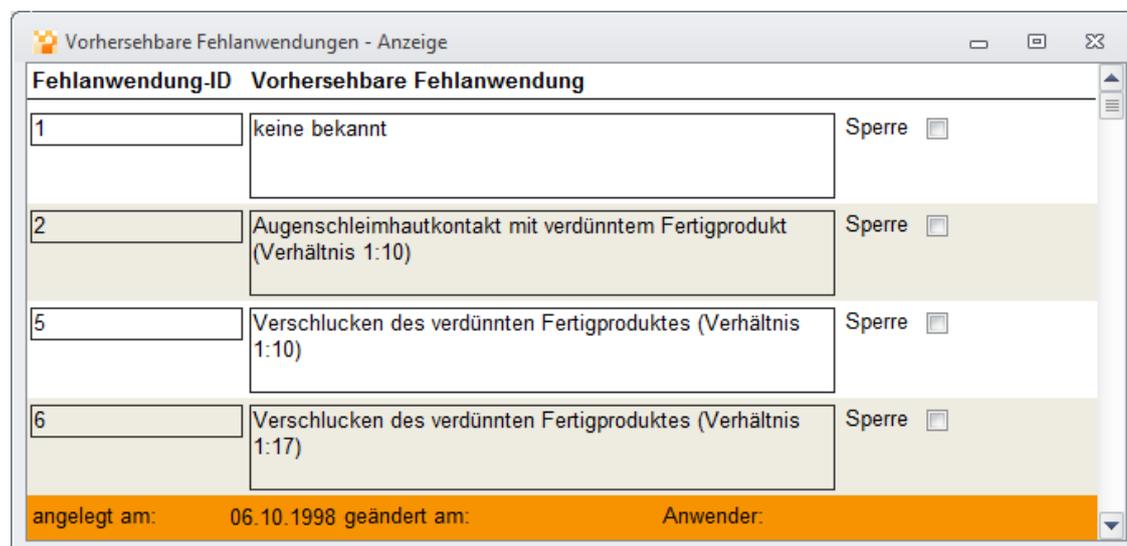

Fehlanwendung-ID	Vorhersehbare Fehlanwendung	Sperrung
1	keine bekannt	<input type="checkbox"/>
2	Augenschleimhautkontakt mit verdünntem Fertigprodukt (Verhältnis 1:10)	<input type="checkbox"/>
5	Verschlucken des verdünnten Fertigproduktes (Verhältnis 1:10)	<input type="checkbox"/>
6	Verschlucken des verdünnten Fertigproduktes (Verhältnis 1:17)	<input type="checkbox"/>

angelegt am: 06.10.1998 geändert am: Anwender: